

شرایط نصب سیستم TE&EB 302 به شرح ذیل می‌باشد.

۱- محل نصب:

مجهز به ارت با مقاومت ۳ اهم (کابل ارت به شکل مفتول مس به هم تأییده و نمره ۳۲ و طول آن کمتر از ۲۸ متر بیشتر باشد)

فاصله سامانه از دیوار: طبق نقشه شکل (۱)

دمای محل نصب: کمتر از ۳۰ درجه

دارای لوله یا دریچه خروجی به فضای بیرون برای شلنگ تهویه سامانه

۲- آب مورد نیاز:

دبی آب مورد نیاز: بیشتر از 30 lit/hr

دمای آب: $15 - 20^\circ\text{C}$

شلنگ ورودی و خروجی آب به میز: دارای قطر خارجی 14 mm و قطر داخلی 12 mm


۳- هوای فشرده:

هوای فشرده مورد نیاز: $5 - 7 \text{ bar}$

شلنگ اتصال هوای فشرده به میز: قطر خارجی 8 mm و قطر داخلی 6 mm

۴- برق:

تک‌فاز، 220 V و 6 kW (حداقل ولتاژ برق شهر 200 V و ماکزیمم مقدار آن 230 V)

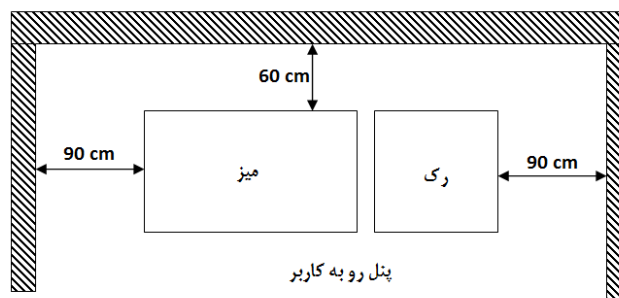

شکل (۱). فاصله مورد نیاز سامانه از دیوار