


# دستگاه ریز بُر

(Microtome)

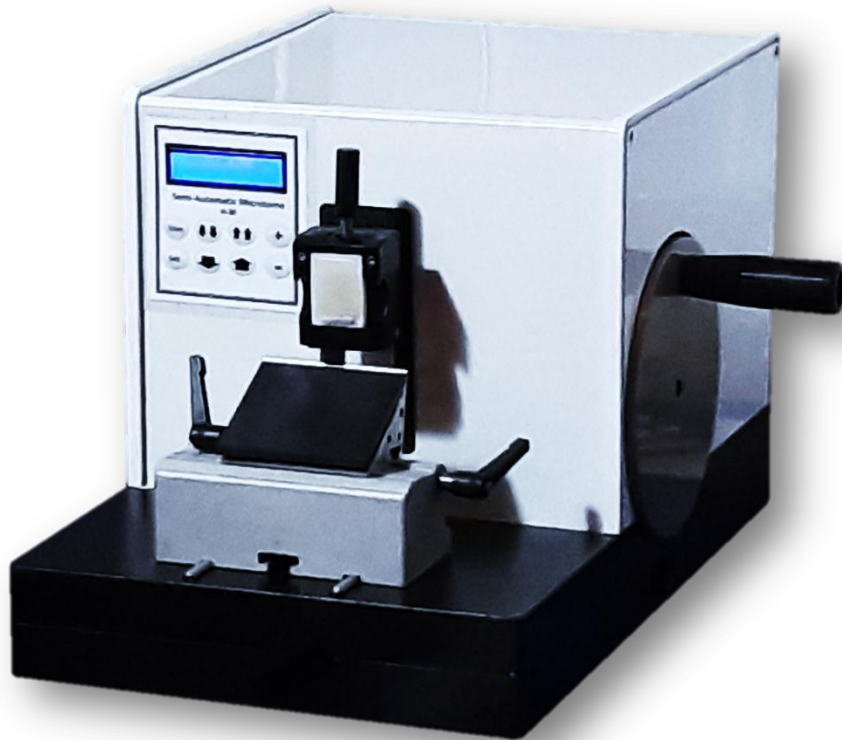

**شرکت علامه رایانه صنعت**

تولید و تعمیر تجهیزات پاتولوژی

تلفکس: ۰۳۱۴۵۸۳۸۷۴۲

همراه: ۰۹۰۲۱۱۳۵۶۷۲

تارنما: [www.Allamehrs.ir](http://www.Allamehrs.ir)

رایانامه: [A.R.S.Co@chmail.ir](mailto:A.R.S.Co@chmail.ir)

## مشخصات کلی

- ✓ وزن: ۲۸ کیلوگرم
- ✓ ابعاد: ۳۰H×۴۰W×۵۰L سانتیمتر
- ✓ رنگ بدنه از نوع الکترواستاتیک
  
- ✓ ۲۲۰ ولت - ۵۰ هرتز
- ✓ حداکثر جریان مصرفی: ۰,۱ آمپر
  
- ✓ نیمه اتوماتیک (کنترل الکترونیکی میکرون دهی)
- ✓ برش از ضخامت ۰,۵ الی ۴۰ میکرون در حالت "برش" و دقت تنظیم (افزایش/کاهش) ۱ میکرون.
- ✓ برش از ضخامت ۱۰ الی ۱۰۰ میکرون در حالت "تریم" (trim) و دقت تنظیم (افزایش/کاهش) ۵ میکرون.
- ✓ بازگشت به عقب فک پس از هر برش (Retraction)
- با قابلیت تنظیم یا حذف
- ✓ بازه حرکت افقی فک بلوک گیر ۲۴mm
- ✓ بازه حرکت عمودی فک بلوک گیر ۶۰mm
- ✓ گیره فک برای گیرش قالب‌های بافت قدیمی بلوکی شکل یا قالب‌های جدید تیشوتک (طبق سفارش)
- ✓ دسته‌ای روان و سبک که موجب خستگی زودهنگام کاربر نمی‌شود