



کنترل فرایند پاسارگاد

منبع تغذیه ولتاژ بالای منفی دیجیتالی

دستگاه NPHV مدل ۲۰۳۹X



NUCLEAR INSTRUMENTS MODULE

شرایط استاندارد

منبع تغذیه ولتاژ بالای منفی دیجیتالی

مدل X۳۹۰

جَنْدِلْ مُحَمَّدْ حَسَنْ

فهرست مطالب

۱	شرایط استاندارد دستگاه
۲	مقدمه استاندارد NIM, CAMAC
۳	استانداردهای سیگنال‌های خطی و منطقی و اتصالات مربوطه
۴	تپ الکتریکی (Pulse)
۵	سیگنال‌های خطی آرام
۶	سیگنال‌های سریع برای زمان‌سنجی
۷	سیگنال‌های منطقی مثبت در استاندارد NIM
۸	سیگنال‌های منطقی منفی در استاندارد NIM
۹	سیگنال‌های منطقی ECL
۱۰	سیگنال‌های منطقی TTL
۱۱	کابل‌ها و کانکتورهای ولتاژ بایاس آشکارساز

شکل‌ها

۱	مشخصات یک تپ نوعی
۵	شکل ۱

جدول‌ها

۱	جدول ۱. محدوده دامنه سیگنال‌های منطقی مثبت در استاندارد NIM
۲	جدول ۲. سایر ملاحظات مربوط به سیگنال‌های منطقی مثبت
۳	جدول ۳. محدوده دامنه سیگنال‌های منطقی منفی در استاندارد NIM
۴	جدول ۴. استاندارد سیگنال‌های منطقی ECL در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
۵	جدول ۵. سطوح سیگنال استاندارد برای منطق TTL

۱ شرایط استاندارد دستگاه

این دستگاه جزء دستگاه استاندارد NIM می‌باشد درنتیجه شرایط متعارف آزمایشگاهی مرتبط با این استاندارد شامل این دستگاه می‌گردد. نحوه کار و نصباین مازولها در کاتالوگ و استاندارد موجود در مازولهای NIM, CAMAC می‌باشد که بصورت خلاصه در ادامه ذکر شده است.

در این مستند موارد مهم ذکر شده است. لذا، در صورت هر گونه ابهام در متن این مستند تیم فنی این شرکت آمادگی پاسخگویی و رفع تمامی ابهامات را دارد.

۲ مقدمه استاندارد NIM, CAMAC

ابزارهای مختلفی در صنایع طیفسنجی (پرتویی) مبتنی بر مازولهای NIM, CAMAC ساخته می‌شوند. از جمله آن‌ها می‌توان به طیفسنجها، تفکیک‌کنندها و جداسازها اشاره نمود. مازولهای NIM, CAMAC عموماً مبتنی بر استانداردهای مشخصی ساخته می‌شوند که این استانداردها منجر به افزایش قابلیت تعویض‌پذیری و ارتقاء ابزارهای پرتویی می‌گردد. بنابراین تولید مازولهای استاندارد NIM, CAMAC یک دانش استراتژیک برای کار در زمینه صنایع پرتویی، لیزر، فیزیک ذرات بنیادین و انرژی بالا است. مستندی که تهیه شده است در واقع خلاصه‌ای از مازولهای استاندارد NIM, CAMAC است. امروزه در صنایع مختلف ملزمات متنوعی برای دستگاههایی که قصد ورود به آن صنایع را دارند تعریف شده است. این ملزمات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تضمین کننده کاربری آسان دستگاه در محیط عملکردی آن است. مجموعه این ملزمات تحت عنوان استانداردهای صنعت طراحی و در اختیار سازندگان دستگاهها قرار می‌گیرد.

صنعت پرتویی و فیزیک ذرات انرژی بالا از جمله صنایعی است که استانداردهای متنوعی را برای دستگاه‌های مختلفی که قرار است در این صنعت مورد استفاده قرار گیرند طراحی و در اختیار تولیدکنندگان دستگاهها قرار داده است. از جمله این دستگاه‌ها مازول‌های NIM هستند که دو سری استاندارد برای آن‌ها طراحی شده است. این دو استاندارد با نام‌های استاندارد NIM و استاندارد CAMAC شناخته می‌شوند.

دو استاندارد NIM و CAMAC دربرگیرنده طیف وسیعی از ویژگی‌های الکتریکی و مکانیکی است که منجر می‌شود قیمت تمام شده محصول برای کاربر کمتر شود و در عین حال کار با ابزار با سهولت بیشتری انجام شود. دو ویژگی بسیار مهم این دو استاندارد انعطاف‌پذیری و تعویض‌پذیری است. این دو ویژگی سبب می‌شوند کاربر ابتدا ویژگی‌هایی که برای ابزار نیاز دارد را تعیین نماید و سپس ابزار مطابق با آن ویژگی‌ها را از سازنده تحويل گیرد. مزیت دیگری که این دو ویژگی ایجاد می‌نمایند این است که می‌توان دستگاه‌های موجود را با افزودن تعداد محدودی مازول جدید به روز کرد و در نتیجه توانایی‌های ابزار را توسعه داد. وجود ویژگی‌های انعطاف‌پذیری و تعویض‌پذیری سبب می‌شود با افزایش نیازهای عملی و همچنین تجاری شدن تکنولوژی‌های جدید بدون نگرانی نسبت به انطباق‌پذیری، مازول‌های جدید را به دستگاه اضافه نمود.

در هر دو استاندارد NIM و CAMAC مازول‌های یک ابزار در داخل قاب قرار می‌گیرند و توان مصرفی خود را از یک منبع توان استاندارد که در انتهای قاب قرار گرفته است، تامین می‌نمایند. استاندارد CAMAC و NIM دو تفاوت عمده نیز با یکدیگر دارند. تفاوت اول گذرگاه داده دیجیتال داخلی است که در CAMAC وجود دارد و تمام قاب‌ها به آن اتصال دارند و ارتباط بین مازول‌ها را برقرار می‌کند. تفاوت دوم نیز در عرض حداقل مازول‌ها در دو استاندارد است. در استاندارد CAMAC عرض حداقل مازول دقیقاً نصف استاندارد NIM است. مازول‌های مطابق با هر کدام از این استانداردها را می‌توان در استاندارد دیگر استفاده نمود ولی به منظور تامین توان مازول باید از آدپتور استفاده نمود.

استاندارد NIM


در این قسمت می‌خواهیم به برخی از مواردی که در استاندارد NIM آورده شده است و همچنین برخی از ملاحظات مورد نیاز در طراحی محصولات اشاره نماییم.

۱-۲ استانداردهای سیگنال‌های خطی و منطقی و اتصالات مربوطه

از آنجایی که بسیاری از محصولات صنایع پرتویی از هر دو مدل سیگنال‌های خطی و منطقی استفاده می‌کنند، لازم است هنگام طراحی محصول به نوع سیگنالی که قرار است از اتصال عبور کند توجه شود. دامنه سیگنال‌های خطی اطلاعاتی از شارژ و انرژی ساطع شده طی یک فرآیند آشکارسازی را نشان می‌دهد و در نتیجه دامنه این سیگنال‌ها در محدوده وسیعی از مقادیر تغییر می‌کند. آنالیز دامنه سیگنال خطی در یک دستگاه، طیف ارتفاع پالس پدیده آشکار شده را ایجاد می‌نماید. در مقابل، سیگنال‌های منطقی شکل و دامنه ثابتی دارند. این سیگنال‌ها به منظور شمارش یک پدیده، ایجاد اطلاعات زمانی و کنترل فرآیندهای بعدی استفاده می‌شوند. پیشنهاد ساخت در شرکت کنترل فرایند پاسارگاد این است که برای هر دو نوع اتصال از کابل هم‌محور و کانکتورهای مبتنی بر استانداردهای LEMO، BNC و یا SMA استفاده شود. برخی از اتصالات منطقی نیز با استفاده از کابل ریبن و چندسیمه مختوم به کانکتورهای چند پین ساخته شود.

۲-۲ تپ الکتریکی (Pulse)

اطلاعات در الکترونیک هسته‌ای توسط علامت‌های تپی، کد می‌شوند. تپ‌ها موج سریعی از جریان یا ولتاژ می‌باشند که اطلاعات در یک مشخصه یا بیشتر از این موج مانند قطبیت، دامنه و شکل نهفته است. در ادامه برخی از ویژگی‌های اساسی تپ‌ها را تعریف می‌کنیم. شکل ۲ یک تپ مستطیلی ایده‌آل از جریان یا ولتاژ را بصورت تابعی از زمان نشان می‌دهد. در الکترونیک هسته‌ای این مقیاس زمانی از میکرو ثانیه تا کسری از نانوثانیه گسترده شده است.

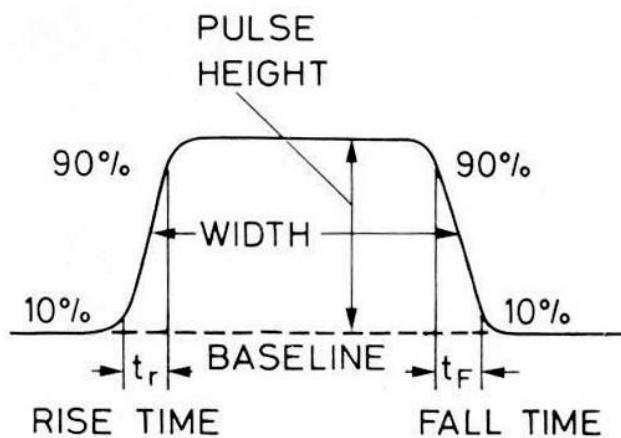

شکل ۱ مشخصات یک تپ نوعی.

- خط پایه (Baseline): خط پایه یک علامت سطح ولتاژ یا جریانی است که تپ افت می‌کند در حالیکه این سطح معمولاً صفر است این امکان وجود دارد که به علت وجود یک جریان یا ولتاژ DC یا نوسان شکل تپ، خط پایه در سطح دیگری قرار گیرد.
- ارتفاع تپ یا دامنه (Pulse height or Amplitude): منظور میزان ارتفاع تپ از بیشترین مقدار تا خط پایه زیر این پیک است.
- عرض علامت (Signal Width): عرض کامل علامت که معمولاً در نیمه ارتفاع علامت (FWHM) اندازه‌گیری می‌شود.
- لبه بالا رونده (Leading Edge): سطحی از علامت که ابتدا ظاهر می‌شود.
- لبه پایین رونده (Falling edge): لبه پایین رونده یا دم، قسمتی از علامت که آخر ظاهر می‌شود.
- زمان صعود (Risetime): زمانی که طول می‌کشد که ارتفاع تپ از ۱ درصد به ۹۰ درصد ارتفاع کامل خود برسد، زمان صعود اصولاً تعیین کننده سرعت علامت بوده و در آزمایشات زمان گیری فوق العاده مهم است.

۱-۲-۲ سیگنال‌های خطی آرام

سیگنال‌های آرام عموما زمان صعودی بیشتر از ۵۰ نانوثانیه دارند و مدت زمان آن‌ها از ۰/۵ میکروثانیه تا ۱۰۰ میکروثانیه است. پیشنهاد ما برای این سیگنال‌ها انطباق آن‌ها بر استاندارد-NIM میکروثانیه Standard Preferred Practices برای محدوده ۰ تا ۱۰ ولت است. سیگنال‌های خطی آرام امکان دارد تکقطبه با پلاریته مثبت و یا دوقطبیه با پلاریته مثبت در ابتدا باشند. در هر کدام از حالات، محدوده ۰ تا ۱۰ ولت است که به منظور استخراج اطلاعات دامنه پالس آنالیز می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های مهمی که باید در طراحی دستگاه‌های NIM استاندارد مورد توجه قرار گیرد امپدانس خروجی پایین است. امپدانس پایین باعث می‌شود که بتوان هر باری را بدون از دست دادن دامنه سیگنال، به خروجی متصل نمود. مقدار قابل قبول برای امپدانس خروجی را می‌توان R_{out} کمتر از ۵۰ اهم در نظر گرفت. این امپدانس باعث می‌شود که بتوان هر باری را بدون از دست دادن دامنه سیگنال به خروجی دستگاه متصل نمود. امپدانس پایین خروجی یک دستگاه استفاده از آن را در کاربردهایی که نیاز به بارهای موازی در خروجی دارد، سهولت می‌بخشد. برای اتصال سیگنال‌های آرام بین مازول‌ها نیز معمولاً از یک کابل هم محور ۹۳ اهمی مانند U/ RG-62A می‌توان استفاده نمود.

یک مشکل بالقوه که در دستگاه‌های با امپدانس خروجی پایین وجود دارد نوسان ایجاد شده ناشی از بازتاب سیگنال از کابل‌های بدون بار و با طول زیاد (مثلًا بیشتر از ۱/۵ متر) است. به این منظور کابل‌های هم محور ۹۳ اهمی طولانی باید به یک بار ۹۳ اهمی ختم شوند. این کار معمولاً با موازی کردن بار ورودی مازول بعدی (که معمولاً ۱۰۰ اهم است) با یک مقاومت ۱۰۰۰ اهمی انجام می‌شود که در نتیجه این موازی‌سازی بار دیده شده در انتهای کابل در حدود ۹۳ اهم می‌گردد.

۲-۲-۲ سیگنال‌های خطی سریع برای زمان‌سنجی

سیگنال‌های سریع خطی برای زمان‌سنجی نوعاً زمان صعودی کمتر از چند نانوثانیه دارند و مدت زمان آن‌ها نیز کمتر از ۱ میکروثانیه است. به طور پیش‌فرض این سیگنال‌ها از آنود یک PMT گرفته می‌شوند اما این کار باعث می‌شود که پلاریته سیگنال منفی شود. محدوده دامنه برای این سیگنال‌ها معمولاً -5 mV تا $+5 \text{ mV}$ و -10 mV تا $+10 \text{ mV}$ است و با توجه به دستگاه تولیدکننده آن تعیین می‌شود. به دلیل زمان صعود کوتاه، پیشنهاد ما برای اتصالات داخلی بین مازول‌ها استفاده از کابل‌های هم محور 50Ω است به گونه‌ای که تمامی کابل‌ها نیز به یک بار 50Ω اهمی ختم گردند. برای مازول‌هایی که امپدانس ورودی بالایی دارند نیز می‌توان یک امپدانس 50Ω اهمی را با امپدانس ورودی موازی نمود.

۳-۲ سیگنال‌های منطقی مثبت در استاندارد NIM

این سیگنال‌ها به عنوان سیگنال‌های منطقی سرعت کم به متوسط با نرخ تکرار از dc تا ۱ مگاهرتز استفاده می‌شوند. جدول ۱ محدوده دامنه این سیگنال‌ها در استاندارد NIM را نشان می‌دهد.

جدول ۱. محدوده دامنه سیگنال‌های منطقی مثبت در استاندارد NIM

خروجی	ورودی	
$+4 \text{ V}$ تا $+12 \text{ V}$ ولت	$+3 \text{ V}$ تا $+12 \text{ V}$ ولت	منطق ۰
$+1 \text{ V}$ تا -2 V ولت	$+1.5 \text{ V}$ تا -2 V ولت	منطق ۱

علاوه بر موارد فوق ملاحظات دیگری نیز در شرکت کنترل فرایند پاسارگاد مورد نظر است که در

جدول ۲ آورده شده است.

جدول ۲. سایر ملاحظات مربوط به سیگنال‌های منطقی مثبت

امپدانس خروجی	امپدانس ورودی	عرض پالس
کمتر از $10 \text{ M}\Omega$	بیشتر از $1000 \text{ M}\Omega$	5 ns نانوثانیه

۴-۲ سیگنال‌های منطقی منفی در استاندارد NIM

سیگنال‌های منطقی منفی زمانی استفاده می‌شوند که زمان صعود و نرخ تکرار مورد نیاز توسط سیگنال‌های مثبت قابل پیاده‌سازی نیست. در استاندارد، محدوده دامنه آن‌ها به صورت نشان داده شده در جدول ۳ است.

جدول ۳. محدوده دامنه سیگنال‌های منطقی منفی در استاندارد NIM

خروجی	ورودی	
-۱ تا +۱ میلی‌آمپر	+۲۰ تا ۴ میلی‌آمپر	منطق ۰
-۱۸ تا -۱۴ میلی‌آمپر	-۳۶ تا -۱۲ میلی‌آمپر	منطق ۱

۵-۲ سیگنال‌های منطقی ECL

در عمل هنگام استفاده از تعداد زیادی آشکارساز مشابه، انجام عملیات تکراری در کانال‌های هر آشکارسازی نیازمند تعداد بالایی اتصال است. به منظور بهبود نحوه اتصالات بین مازول‌ها در محصولاتی که با شرایط فوق تولید می‌شوند معمولاً از کانکتورهای ۳۴ پین استفاده می‌شود. استاندارد مورد استفاده برای سیگنال‌های منطقی سریع در این سیستم ECL است. این استاندارد در دمای ۲۵ درجه در جدول ۴ آورده شده است:

جدول ۴. استاندارد سیگنال‌های منطقی ECL در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد

خروجی	ورودی	
-۰.۹۸ تا -۰.۸۱ ولت	-۰.۸۱ تا -۱.۱۳ ولت	حالت بالا
-۱.۶۳ تا -۱.۵۹ ولت	-۱.۴۸ تا -۱.۹۵ ولت	حالت پایین

۶-۲ سیگنال‌های منطقی TTL

توابع منطقی آرام در داخل ابزارها معمولاً با مدارهای مجتمعی طراحی می‌شوند که از استاندارد منطقی TTL استفاده می‌نمایند. سطوح سیگنال استاندارد برای منطق TTL در جدول ۵ آورده شده است:

جدول ۵. سطوح سیگنال استاندارد برای منطق TTL

خروجی	ورودی	
۰ تا +۰.۴ ولت	۰ تا +۰.۸ ولت	منطق ۰
+۰.۴ تا +۰.۵ ولت	+۰.۸ تا +۰.۹ ولت	منطق ۱

۷-۲ کابل‌ها و کانکتورهای ولتاژ بایاس آشکارساز

آشکارسازهای برای کار مطلوب معمولاً به ولتاژ بایاس احتیاج دارند. ولتاژ بایاس آشکارسازها با توجه به نوع آشکارساز معمولاً از چند ولت تا چند هزار ولت تغییر می‌کند. در یک PMT، ولتاژ بایاس از طریق یک شبکه مقاومتی به کاتد، داینود و آند در بیس PMT متصل می‌شود. انواع دیگر آشکارساز نیز ولتاژ بایاس خود را از یک شبکه فیلتری که در پیش‌تقویت‌کننده وجود دارد تامین می‌کنند. برای ولتاژها تا ۵ کیلوولت مستقیم، اتصال منبع توان بایاس به پیش‌تقویت‌کننده یا بیس از طریق کابل هم‌محور U/RG-59A و کانکتورهای SHV انجام می‌شود.



کنترل فرایند پاسارگاد

w w w . c f p . c o . i r