

آدرس : کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان آزمایشگاه
مرکزی اتاق 33
شماره تماس : 031- 5591 3383 09136425874

ایمیل : mohamadrezanazeri1986@gmail.com




اسپکترومتر با آشکارساز آرایه‌ای (CCD Array)

Spec 3700





اسپکترومتر با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت اندازه‌گیری طیف در ناحیه مرئی-مادون قرمز نزدیک را بطور همزمان دارد. نرم‌افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و همچنین ذخیره و انتقال اطلاعات به Excel را ارائه می‌نماید.

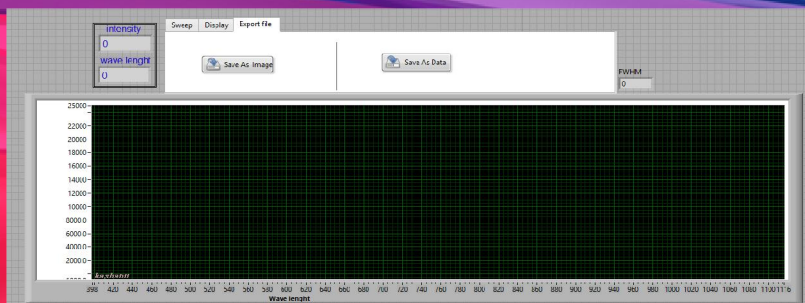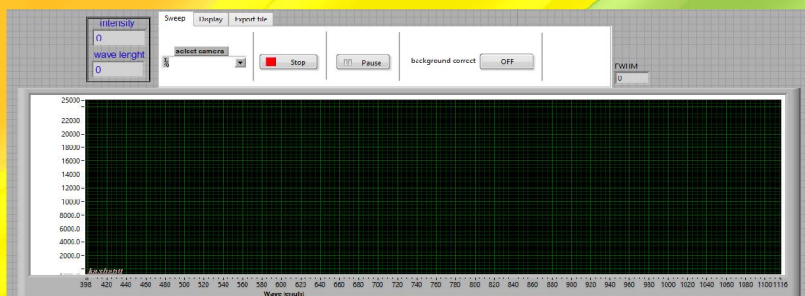

مشخصات اپتیکی دستگاه	
Wavelength range	400-1100 nm
Resolution	1 nm
Wavelength accuracy	$\pm 1 \text{ nm}$
Scantime	$10 \mu\text{s} - 1\text{s}$
Detector	Array CCD
Fiber type	FCPC , SMA
مشخصات فیزیکی دستگاه	
Communication	Usb2
Software	Win XP – Win7– Win8
Height×width×depth	15cm×21cm×7cm
Weight	2kg
Power	Usb2

Price 5000000