

آدرس : کاشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان آزمایشگاه
مرکزی اتاق 33
شماره تماس : 031- 5591 3383 09136425874

ایمیل: mohamadrezanazeri1986@gmail.com




اسپکترومتر با آشکارساز دوبعدی

Spec 1920





اسپکترومتر با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت اندازه‌گیری طیف در ناحیه مرئی-مادون قرمز نزدیک را بطور همزمان دارد. نرم‌افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و همچنین ذخیره و انتقال اطلاعات به Excel را ارائه می‌نماید.

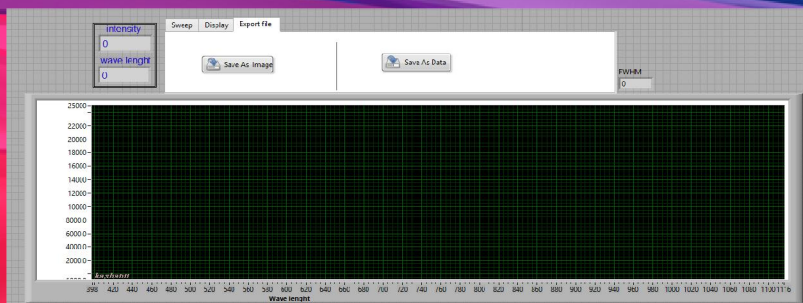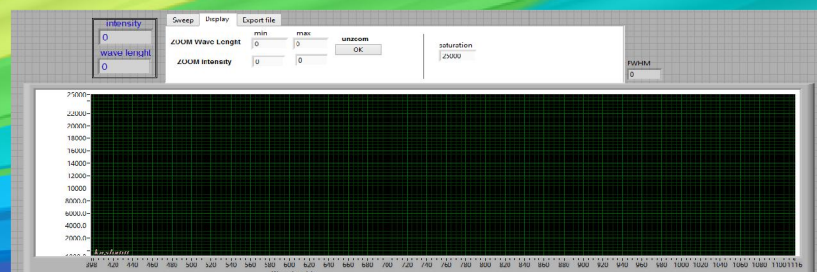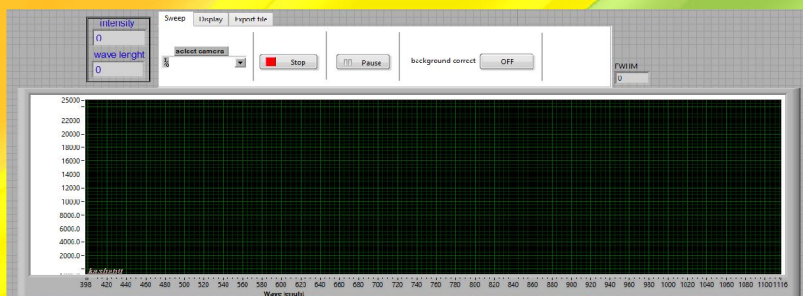

مشخصات اپتیکی دستگاه

Wavelength range	400-1100 nm
Resolution	1-4 nm
Wavelength accuracy	1-4 nm
Scantime	30 f/s
Detector	2D CCD
Fiber type	FCPC , SMA

مشخصات فیزیکی دستگاه

Communication	Usb2
Software	Win XP – Win7– Win8
Height×width×depth	15cm×21cm×7cm
Weight	2kg
Power	Usb2

Price 3700000 Rial